

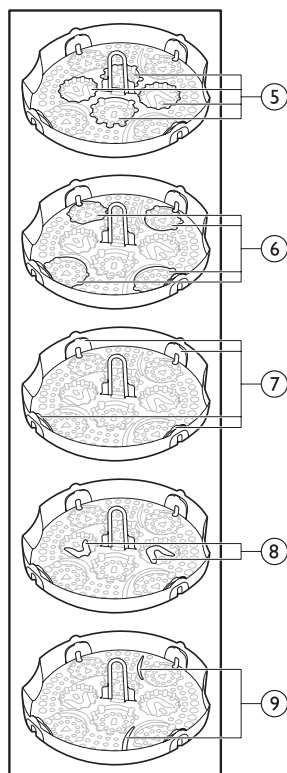
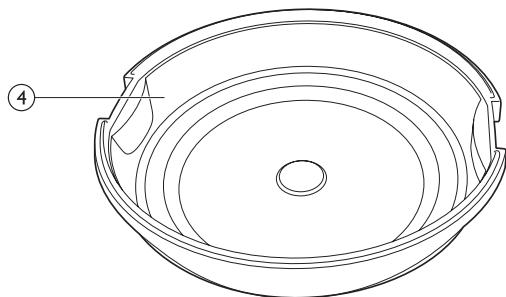

















PHILIPS

AVENT

SCF283, SCF282,
SCF281

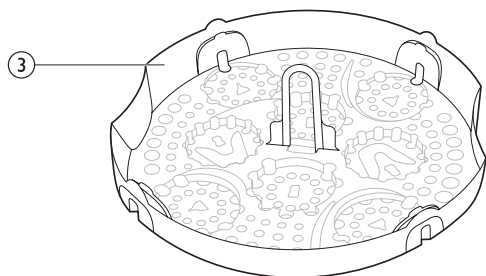

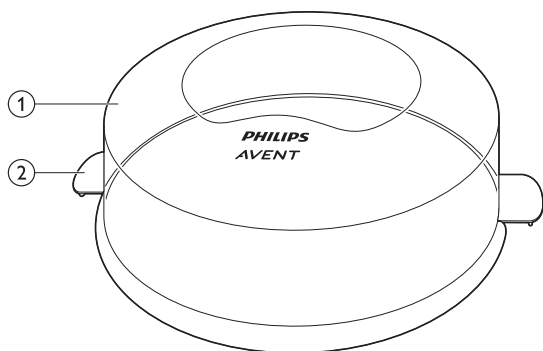



SCF283, SCF282, SCF281

ENGLISH 5

ESPAÑOL 11

FRANÇAIS (CANADA) 17

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- 1 Lid
- 2 Clips
- 3 Basket
- 4 Base
- 5 Bottle cavities
- 6 Nipple cavities
- 7 Dome cap holders
- 8 Slots for large bottles

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this microwave sterilizer, basic safety precautions should always be followed including the following:

- 1 Read all instructions.
- 2 Extreme caution must be used when moving or opening the sterilizer. The water inside may still be hot. Always let the sterilizer cool down before moving, cleaning or storing it.
- 3 Take care when opening the sterilizer after sterilizing, as steam can burn.
- 4 Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- 5 Do not use the sterilizer for other than intended use.
- 6 Always keep the sterilizer out of reach of children.
- 7 Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- 8 Do not use chemical sterilizing solutions/tablets or bleach in your sterilizer or on products to be sterilized.
- 9 Using of homeopathic additives in water can have negative influence in steam, health and can damage plastic parts.
- 10 Do not use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as bleach, petrol or acetone to clean the sterilizer.
- 11 Do not use softened water in the sterilizer.
- 12 HOUSEHOLD USE ONLY.
- 13 Never use the sterilizer in the microwave without pouring water into the base. Always make sure the base is filled with 7oz (200ml) of water before you start sterilizing.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Caution

- Never use any accessories or parts from other manufacturers or parts that are not specifically recommended by Philips. If you use such accessories or parts, your warranty becomes invalid.
- Do not place metal items in the sterilizer, as this may damage the microwave.
- Use distilled water, bottled water or fresh running water without any additives.
- Only sterilize baby feeding products that have been approved for sterilization.
- Do not overload the sterilizer, otherwise the items are not sterilized properly.
- Do not expose the sterilizer to extreme heat or direct sunlight.
- Pour out any remaining water after it has cooled down.
- Always wash your hands before you touch the sterilized items.

Before first use

Before you use the sterilizer for the first time, clean it thoroughly as described below.

- 1** Remove the basket from the base.
- 2** Fill a baby bottle or a measuring cup with exactly 7oz (200ml) tap water and pour into the base (Fig. 2).

The amount of water needs to be exactly 7oz (200ml). When the base contains too much water, the items will not be sterilized properly. When the base does not contain enough water, this can cause damage to the sterilizer or microwave.

- 3** Place the basket in the base (Fig. 3).
- 4** Put the lid on the sterilizer (1) and push down the clips to lock the lid into place (2). (Fig. 4)
- 5** Place the sterilizer in the microwave. (Fig. 5)

Note: Make sure that the microwave is clean and dry before you start sterilizing.

Note: If you have a combination oven, make sure that the oven or grill is turned off and has cooled down before you put the sterilizer in it.

- 6** Select the appropriate microwave wattage and time (see the table in chapter 'Using the microwave sterilizer') and let the microwave operate.
- 7** After the microwave has finished, open it and let the sterilizer cool down before you remove it from the microwave.
- 8** Pull open the clips (1) and remove the lid (2) (Fig. 6).
- 9** Pour out the remaining water and rinse the base and basket thoroughly.

Preparing for use

Filling the basket

Before you put the items to be sterilized in the basket, clean them thoroughly in the dishwasher or clean them by hand with hot water and some liquid soap. Make sure you remove all milk residues.

Note: *Make sure all items to be sterilized are completely disassembled and place them in the basket with their openings pointing down, to prevent them from filling with water.*

Note: *Do not stack the items too closely together. The steam has to be able to circulate around the items to ensure effective sterilization.*

There are several ways to fill the basket:

Four Philips AVENT feeding bottles

- 1** Place the bottles upside down in the bottle cavities. (Fig. 7)
- 2** Place the nipples in the nipple cavities (Fig. 8).
- 3** Place the screw rings loosely on top of the nipples (Fig. 9).

Note: *Larger screw rings only fit if placed in slanted position over the nipples.*

- 4** Place the dome caps in the dome cap holders (Fig. 10).

Two large Philips AVENT feeding bottles 11oz (330ml)

- 1** Insert the rim of the bottles into the slots for large bottles (Fig. 11).
- 2** Place the nipples in the nipple cavities (Fig. 12).
- 3** Place the screw rings loosely on top of the nipples (Fig. 13).

Note: *Larger screw rings only fit if placed in slanted position over the nipples.*

- 4** Place the dome caps in the dome cap holders (Fig. 14).

Four Philips AVENT storage cups and lids

- 1** Place the storage cups upside down in the basket (Fig. 15).
- 2** Place the lids vertically around the cups. (Fig. 16)

Using the microwave sterilizer

Only place items in the sterilizer that are suitable for sterilizing. Do not sterilize your bottle brush or items that are filled with liquid, e.g. teethingers filled with cooling fluid.

Note: Before you sterilize bottles and other items, clean them first.

- 1** Remove the basket from the base.
- 2** Fill a baby bottle or measuring cup with exactly 7oz (200ml) tap water and pour into the base (Fig. 2).

The amount of water needs to be exactly 7oz (200ml). When the base contains too much water, the items will not be sterilized properly. When the base does not contain enough water, this can cause damage to the sterilizer or microwave.

- 3** Place the basket in the base (Fig. 3).
- 4** Place the items to be sterilized in the basket (see chapter 'Preparing for use').
- 5** Put the lid on the sterilizer (1) and push down the clips to lock the lid into place (2) (Fig. 4).
- 6** Place the sterilizer in the microwave. (Fig. 5)

Note: Make sure that the microwave is clean and dry before you start sterilizing.

- 7** Select the appropriate microwave wattage and time (see table) and let the microwave operate.

Note: If you have a combination oven, make sure that the oven or grill is turned off and has cooled down before you put the sterilizer in it.

Note: Do not exceed the sterilizing time indicated in the table.

Microwave wattage and time

Wattage	sterilizing time	Cool-down time
1200W-1850W	2min.	2min.
850W-1100W	4min.	2min.
500W-800W	6min.	2min.

- 8** After the microwave has finished, open it and let the sterilizer cool down before you remove it from the microwave.

Be careful, hot steam may come out of the microwave.

- 9** Remove the sterilizer from the microwave.

Note: Make sure you keep the sterilizer level to avoid leaking or spilling hot water.

Note: The sterilized items remain sterile for up to 24 hours in the microwave sterilizer if you do not remove the lid.

- 10** Pull open the clips (1) and remove the lid (2) (Fig. 6).

- 11** Remove the bottles and other items from the basket. Use the tongs to remove the smaller items.

Be careful, hot steam may come out of the sterilizer and the sterilized items may still be hot.

- 12** When you have removed the sterilized items, pour out the remaining water, rinse the base and basket thoroughly and wipe all parts dry.

Cleaning

Clean the lid, the basket and the base after every use.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as bleach, petrol or acetone to clean the sterilizer.

Note: Let the sterilizer cool down before you clean it.

- 1** Clean the sterilizer parts in hot water with some liquid soap.

Note: You can also clean the sterilizer parts in the dishwasher.

- 2** After cleaning, dry all parts properly.

Note: After cleaning, store the sterilizer in a clean, dry place.

This product has no other user-serviceable parts. For assistance call 1-800-54-Avent (1-800-542-8368).

Warranty

Full One-Year Warranty

Philips warrants its products for a specific period of time after the first date of purchase. If the product is purchased in the USA, Philips North America LLC (USA) or, if the product is purchased in Canada, Philips Electronics Ltd., warrants this new product against defects in materials or workmanship for a period of one year from the date of purchase (as evidenced by a valid proof of purchase), and agrees to replace any defective product without charge. Philips will refund the purchase price if it is unable to provide replacement.

Parts that are subject to normal wear and tear, accessories, replacement batteries and consumables such as toothbrush heads, are not covered by the terms of this warranty.

IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specified voltage.*

NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

For more information and in order to obtain warranty service, simply go to **www.philips.com/support**.

NOTE: This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state, province to province or country to country. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you. This warranty is transferable.

*Read enclosed instructions carefully.

THE WARRANTY DOES NOT COVER THE FOLLOWING:

- Indirect or consequential damages, such as loss of time, loss of data, or loss of income. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.
- Compensation for activities done by yourself, such as regular maintenance, installing firmware updates, or saving data.

THE WARRANTY DOES NOT APPLY:

- If the proof of purchase, model number, serial number, or production date code on the product has been made illegible.
- If the product was purchased as faulty stock.
- If the defect is the result of abuse or excessive use outside the intended purpose.
- If the defect is caused by environmental conditions, connecting peripherals, additional equipment, or accessories (including software) that are not in accordance with the user manual.
- If the unit has been damaged, including but not limited to damage by animals, lightning, abnormal voltage, fire, natural disaster, transportation, or water (unless the user manual expressly states that the product may be rinsed).
- For non-electrical parts, normal wear and tear, accessories, replacement batteries or replacement of consumable parts such as toothbrush heads.
- If the product does not function properly because it was not originally designed for use in the country where the product is used, which may occur if you import the product.
- If the product does not function properly due to problems with connection with service providers, such as for the internet.

Manufactured for:

Philips Personal Health

A Division of Philips North America LLC

P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904, USA

In Canada: Philips Electronics Ltd

281 Hillmount Road, Markham, ON L6C 2S3

Introducción

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips. Para disfrutar de todos los beneficios que le ofrece la asistencia de Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Información general (Fig. 1)

- 1 Tapa
- 2 Cierres
- 3 Cesta
- 4 Base
- 5 Huecos para los biberones
- 6 Huecos para las tetinas
- 7 Soportes para las tapas
- 8 Ranuras para biberones grandes

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Si utiliza un esterilizador para microondas siempre debe tomar medidas de seguridad básicas, tales como:

- 1 Lea todas las instrucciones.
- 2 Tome las medidas de precaución necesarias cuando mueva o abra el esterilizador. El agua en el interior todavía puede estar caliente. Siempre deje que el esterilizador se enfríe antes de moverlo, limpiarlo o guardarlo.
- 3 Tenga cuidado al abrir el esterilizador después de utilizarlo para evitar sufrir quemaduras con el vapor.
- 4 No toque superficies calientes. Use las manijas o las perillas.
- 5 Utilice el esterilizador solamente para el fin con el que fue creado.
- 6 Mantenga el esterilizador lejos del alcance de los niños.
- 7 No lo coloque sobre quemadores eléctricos o que funcionen con gas caliente ni cerca de ese tipo de aparatos. Tampoco lo coloque dentro de hornos calientes.
- 8 No use líquidos de limpieza o pastillas que contengan químicos ni blanqueadores en su esterilizador ni en los productos que desea esterilizar.
- 9 El uso de aditivos homeopáticos en el agua puede provocar un efecto negativo en el vapor, la salud y puede dañar las piezas de plástico.
- 10 No utilice estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos agresivos, como lejía, gasolina o acetona, para limpiar el esterilizador.
- 11 No use agua ablandada en el esterilizador.
- 12 EXCLUSIVO PARA USO DOMÉSTICO.
- 13 No utilice el esterilizador en el microondas sin verter agua en la base. Asegúrese de que la base tenga 7 onzas (200 ml) de agua antes de comenzar a esterilizar.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Precaución

- No utilice nunca accesorios o piezas de otros fabricantes o que no hayan sido específicamente recomendados por Philips. La garantía quedará anulada si utiliza tales piezas o accesorios.
- No coloque objetos de metal en el esterilizador, ya que pueden dañar el microondas.
- Use agua destilada, agua embotellada o agua corriente sin aditivos.
- Sólo esterilice productos de alimentación para bebés aptos para esterilización.
- No sobrecargue el esterilizador o de lo contrario los objetos no se esterilizarán correctamente.
- No exponga el esterilizador a altas temperaturas ni a la luz solar directa.
- Vierta el agua restante una vez que se haya enfriado.
- Lávese bien las manos antes de tocar los objetos esterilizados.

Antes del primer uso

Antes de utilizar el esterilizador por primera vez, límpielo completamente tal y como se describe a continuación.

1 Saque la cesta de la base.

2 Llene un biberón o un vaso medidor con exactamente 7 onzas (200 ml) de agua del grifo y viértalo en la base (Fig. 2).

La cantidad de agua debe ser exactamente 7 onzas (200 ml). Si la base contiene demasiada agua, los artículos no se esterilizarán correctamente. Si la base no contiene suficiente agua, esto puede causar daños al esterilizador o el microondas.

3 Coloque la cesta en la base (Fig. 3).

4 Coloque la tapa en el esterilizador (1) y presione los cierres para bloquear la tapa en su lugar (2). (Fig. 4)

5 Coloque el esterilizador en el microondas. (Fig. 5)

Nota: Asegúrese de que el microondas está limpio y seco antes de iniciar la esterilización.

Nota: Si tiene un horno combinado, asegúrese de que el horno o el grill están apagados y se han enfriado antes de introducir el esterilizador.

6 Seleccione la potencia y el tiempo apropiados en el microondas (consulte la tabla del capítulo "Utilización del esterilizador para microondas") y deje que éste funcione.

7 Cuando el microondas haya terminado, ábralo y deje que el esterilizador se enfríe antes de retirarlo del microondas.

8 Tire de los cierres para abrirlos (1) y retire la tapa (2) (Fig. 6).

9 Vierta el agua restante y enjuague bien la base y la cesta.

Preparación inicial

Llenado de la cesta

Antes de colocar los objetos que se van a esterilizar en la cesta, lávelos en el lavavajillas o a mano con agua caliente y un poco de detergente líquido. Asegúrese de limpiar todos los restos de leche.

Nota: Asegúrese de que todas las piezas que deben esterilizarse se hayan desmontado completamente y colóquelas en la cesta con las aberturas hacia abajo para evitar que se llenen de agua.

Nota: No coloque los objetos demasiado cerca entre ellos. El vapor debe circular alrededor de los objetos para asegurar una esterilización efectiva.

Hay varias maneras de llenar la cesta:

Cuatro biberones de Philips AVENT

- 1** Coloque los biberones boca abajo en los huecos para los biberones. (Fig. 7)
- 2** Coloque las tetinas en los huecos para las tetinas (Fig. 8).
- 3** Coloque los anillos de cierre sin apretar encima de las tetinas (Fig. 9).

Nota: Los anillos de cierre más grandes sólo encajan si se colocan en una posición inclinada sobre las tetinas.

- 4** Coloque las tapas en los soportes para las tapas (Fig. 10).

Dos biberones de Philips AVENT grandes de 11 onzas (330 ml)

- 1** Introduzca el borde de los biberones en las ranuras para biberones grandes (Fig. 11).
- 2** Coloque las tetinas en los huecos para las tetinas (Fig. 12).
- 3** Coloque los anillos de cierre sin apretar encima de las tetinas (Fig. 13).

Nota: Los anillos de cierre más grandes sólo encajan si se colocan en una posición inclinada sobre las tetinas.

- 4** Coloque las tapas en los soportes para las tapas (Fig. 14).

Cuatro vasos de almacenamiento y tapas de Philips AVENT

- 1** Coloque los vasos de almacenamiento boca abajo en la cesta (Fig. 15).
- 2** Coloque las tapas verticalmente alrededor de los biberones. (Fig. 16)

Utilización del esterilizador para microondas

Coloque sólo objetos que sean apropiados para la esterilización en el esterilizador. No esterilice la escobilla del biberón o elementos que estén llenos de líquido, como por ejemplo un mordedor con refrigerante.

Nota: Antes de esterilizar biberones y otros objetos, límpielos primero.

1 Saque la cesta de la base.

2 Llene un biberón o un vaso medidor con exactamente 7 onzas (200 ml) de agua del grifo y viértalo en la base (Fig. 2).

La cantidad de agua debe ser exactamente 7 onzas (200 ml). Si la base contiene demasiada agua, los artículos no se esterilizarán correctamente. Si la base no contiene suficiente agua, esto puede causar daños al esterilizador o el microondas.

3 Coloque la cesta en la base (Fig. 3).

4 Coloque los objetos que se van a esterilizar en la cesta (consulte el capítulo "Preparación para su uso").

5 Coloque la tapa en el esterilizador (1) y presione los cierres para bloquear la tapa en su lugar (2) (Fig. 4).

6 Coloque el esterilizador en el microondas. (Fig. 5)

Nota: Asegúrese de que el microondas está limpio y seco antes de iniciar la esterilización.

7 Seleccione la potencia y el tiempo apropiados en el microondas (consulte la tabla) y deje que éste funcione.

Nota: Si tiene un horno combinado, asegúrese de que el horno o el grill están apagados y se han enfriado antes de introducir el esterilizador.

Nota: No supere el tiempo de esterilización indicado en la tabla.

Voltaje y potencia en el microondas

Potencia	Tiempo de esterilización	Tiempo de enfriamiento
1200 W a 1850 W	2 min.	2 min.
850 W a 1100 W	4 min.	2 min.
500 W a 800 W	6 min.	2 min.

8 Cuando el microondas haya terminado, ábralo y deje que el esterilizador se enfríe antes de retirarlo del microondas.

Tenga cuidado, puede salir vapor caliente del microondas.

9 Retire el esterilizador del microondas.

Nota: Asegúrese de que mantiene el nivel del esterilizador para evitar que gotee o derrame agua caliente.

Nota: Los objetos esterilizados permanecen estériles hasta 24 horas en el esterilizador para microondas si no retira la tapa.

10 Tire de los cierres para abrirlos (1) y retire la tapa (2) (Fig. 6).

11 Retire los biberones y los demás objetos de la canasta. Utilice las pinzas para retirar los objetos más pequeños.

Tenga cuidado, puede salir vapor caliente del esterilizador y los objetos esterilizados aún pueden estar calientes.

12 Cuando retire los objetos esterilizados, vierta el agua restante, enjuague bien la base y la cesta y seque todas las piezas.

Limpieza

Limpie la tapa, la cesta y la base después de cada uso.

No utilice estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos agresivos, como lejía, gasolina o acetona, para limpiar el esterilizador.

Nota: Deje que el esterilizador se enfríe antes de limpiarlo.

1 Lave las piezas del esterilizador con agua caliente y un poco de detergente líquido.

Nota: También puede lavar las piezas del esterilizador en el lavavajillas.

2 Tras la limpieza, seque todas las piezas correctamente.

Nota: Cuando complete la limpieza, guarde el esterilizador en un lugar limpio y seco.

El producto no contiene ninguna otra pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para solicitar asistencia, comuníquese al 1-800-54-Avent (1-800-542-8368).

Garantía

Garantía Total de Un Año

La garantía de Philips cubre los productos por un período de tiempo específico después de la primera fecha de compra. La garantía de Philips North America LLC (EE. UU.) cubre este producto nuevo comprado en EE. UU. contra defectos de materiales o mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra (como se evidencia mediante un comprobante de compra válido) y acepta reemplazar cualquier producto defectuoso sin cargo. Si el producto fue comprado en Canadá, la garantía es de Philips Electronics Ltd. Philips reembolsará el total de la compra si no puede proporcionar el reemplazo.

Las piezas que están sujetas a desgaste normal, accesorios, baterías de repuesto y consumibles como cabezales de cepillos dentales, no están cubiertos por los términos de esta garantía.

IMPORTANTE: Esta garantía no cubre ningún daño que surja como resultado de un accidente, del uso indebido o abuso, de la falta de cuidado razonable, del uso de cualquier accesorio no provisto con el producto, de la pérdida de piezas o del uso del producto bajo un voltaje no especificado.*

NO SE ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, FORTUITO O RESULTANTE.

Para obtener más información y el servicio de garantía, vaya a www.philips.com/support.

NOTA: Esta garantía le brinda derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos los cuales varían de estado a estado, de región en región o de país en país. En algunos estados no se permite la exclusión o la limitación de los daños fortuitos o resultantes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas anteriormente no apliquen a su caso. Esta garantía es transferible.

*Lea las instrucciones adjuntas atentamente.

LA GARANTÍA NO CUBRE LO SIGUIENTE:

- Daños indirectos o resultantes, como pérdida de tiempo, pérdida de datos o pérdida de ingresos. En algunos estados no se permite la exclusión o la limitación de los daños fortuitos o resultantes, de modo que es posible que la limitación mencionada anteriormente no aplique a su caso.
- Compensación por actividades que usted realizó, como mantenimiento periódico, instalación de actualizaciones de firmware o almacenamiento de datos.

LA GARANTÍA NO SE APLICA A:

- Si el comprobante de compra, número de modelo, número de serie o código de fecha de producción del producto se han vuelto ilegibles.
- Si el producto fue comprado como producto defectuoso.
- Si el defecto es resultado de un abuso o uso excesivo diferente del fin previsto.
- Si el defecto es causado por condiciones ambientales, conexión de periféricos, equipos adicionales o accesorios (incluido el software) que no estén de acuerdo con el manual del usuario.
- Si la unidad ha sufrido daños, incluidos, entre otros, daños causados por animales, rayos, voltaje anormal, incendio, desastre natural, transporte o agua (a menos que el manual del usuario indique expresamente que el producto puede enjuagarse).
- Para piezas no eléctricas, desgaste normal, accesorios, baterías de repuesto o reemplazo de piezas consumibles, como cabezales de cepillos dentales.
- Si el producto no funciona correctamente porque no fue diseñado para su uso en el país donde se utiliza el producto, lo que puede ocurrir si importa el producto.
- Si el producto no funciona correctamente debido a problemas de conexión con los proveedores de servicios, como Internet.

Fabricado para:

Philips Personal Health

Una división de Philips North America LLC

P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904, USA.

En Canadá: Philips Electronics Ltd

281 Hillmount Road, Markham, ON L6C 2S3

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement du soutien de Philips, enregistrez votre produit à l'adresse :

www.philips.com/welcome.

Description générale (fig. 1)

- 1 Couvercle
- 2 Attaches
- 3 Panier
- 4 Base
- 5 Emplacements pour biberons
- 6 Emplacements pour tétines
- 7 Porte-capuchons
- 8 Logements pour grands biberons

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez ce stérilisateur pour micro-ondes, suivez toujours les mesures de sécurité fondamentales, notamment ce qui suit :

- 1 Lisez toutes les instructions.
- 2 Faites preuve de la plus grande prudence lorsque vous déplacez ou que vous ouvrez le stérilisateur. L'eau à l'intérieur peut être brûlante. Laissez toujours l'appareil refroidir avant de le déplacer, de le nettoyer ou de le ranger.
- 3 Soyez vigilant lorsque vous ouvrez le stérilisateur après stérilisation car la vapeur peut provoquer des brûlures.
- 4 Ne touchez pas les surfaces chaudes, mais servez-vous des poignées ou boutons.
- 5 N'utilisez le stérilisateur pour aucun autre usage que celui prévu.
- 6 Gardez le stérilisateur hors de portée des enfants.
- 7 Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique, ni sur un four chaud.
- 8 N'utilisez aucun produit chimique de stérilisation ou de javellisation sur votre stérilisateur, ni sur les objets que vous souhaitez stériliser.
- 9 Évitez d'utiliser des additifs homéopathiques dans l'eau, car ils peuvent nuire à la vapeur et à la santé, mais aussi endommager les petites pièces en plastique.
- 10 N'utilisez pas de tampons à récurer, de nettoyants abrasifs ou de produits puissants tels que de l'eau de Javel, de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.
- 11 N'utilisez pas d'eau adoucie dans le stérilisateur.
- 12 CET APPAREIL EST DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.
- 13 Ne mettez jamais le stérilisateur dans le micro-ondes sans avoir pris soin de verser 200 ml (7 oz) d'eau dans sa base au préalable.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

Avertissement

- N'utilisez aucun accessoire, ni aucune pièce provenant d'un autre fabricant ou non spécifiquement recommandé par Philips. Le non respect de cette consigne entraîne l'annulation de votre garantie.
- Ne placez aucun objet métallique dans le stérilisateur, car vous risqueriez d'endommager le micro-ondes.
- Utilisez de l'eau distillée, en bouteille ou du robinet, sans y mélanger d'additif.
- Ne stérilisez que des accessoires destinés à l'alimentation des bébés pour lesquels la stérilisation est approuvée.
- Ne surchargez pas le stérilisateur, car cela nuirait au bon déroulement de la stérilisation.
- N'exposez pas le stérilisateur à des chaleurs intenses ou à la lumière directe du soleil.
- Une fois l'eau restante refroidie après utilisation, videz-la.
- Lavez-vous toujours les mains avant de toucher les objets stérilisés.

Avant la première utilisation

Avant la première utilisation du stérilisateur, nettoyez-le soigneusement en procédant comme suit.

- 1** Retirez le panier de la base.
- 2** Versez précisément 200 ml (7 oz) d'eau du robinet dans la base à l'aide d'un biberon ou d'un gobelet gradué (fig. 2).

Veillez à utiliser très exactement 200 ml (7 oz) d'eau car si vous en utilisez trop, la stérilisation ne se déroulera pas correctement et si vous n'en utilisez pas assez, vous risquez d'endommager le stérilisateur ou le micro-ondes.

- 3** Déposez le panier dans la base (fig. 3).
- 4** Placez le couvercle sur le stérilisateur (1) et appuyez sur les attaches pour le maintenir en place (2). (fig. 4)
- 5** Placez le stérilisateur dans le micro-ondes. (fig. 5)

Remarque : Assurez-vous que le micro-ondes est propre et sec avant de lancer la stérilisation.

Remarque : Si vous utilisez un four combiné, veillez à ce que le four ou le grill soit éteint et froid avant d'insérer le stérilisateur.

- 6** Choisissez la puissance et la durée appropriée (voir le tableau de la section «Utilisation du stérilisateur pour micro-ondes») et démarrez le micro-ondes.
- 7** Une fois le cycle terminé, ouvrez le micro-ondes et laissez le stérilisateur refroidir avant de l'en retirer.
- 8** Soulevez les attaches (1) et retirez le couvercle (2) (fig. 6).
- 9** Videz l'eau restante et rincez soigneusement la base et le panier.

Avant l'utilisation

Remplissage du panier

Avant de déposer des objets dans le panier, assurez-vous de les nettoyer soigneusement, soit au lave-vaisselle, soit à la main avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Vérifiez bien qu'il ne reste plus de résidu de lait.

Remarque : Assurez-vous que tous les objets à stériliser sont entièrement démontés et placés dans le panier avec leur ouverture orientée vers le bas pour éviter que de l'eau ne s'accumule à l'intérieur.

Remarque : Ne serrez pas trop les objets entre eux pour que la vapeur puisse circuler librement afin de garantir l'efficacité de la stérilisation.

Il existe plusieurs configurations de remplissage du panier :

Quatre biberons Philips AVENT

- 1** Placez les biberons à l'envers dans les emplacements qui leur sont réservés. (fig. 7)
- 2** Placez les tétines dans les emplacements à cet effet (fig. 8).
- 3** Déposez les bagues de serrage sur les tétines (fig. 9).

Remarque : Pour tenir, les bagues de serrage de grande taille doivent être placées de biais sur les tétines.

- 4** Placez les capuchons sur le porte-capuchons (fig. 10).

Deux grands biberons Philips AVENT de 330 ml (11 oz)

- 1** Insérez les rebords des biberons dans les logements pour grands biberons (fig. 11).
- 2** Placez les tétines dans les emplacements à cet effet (fig. 12).
- 3** Déposez les bagues de serrage sur les tétines (fig. 13).

Remarque : Pour tenir, les bagues de serrage de grande taille doivent être placées de biais sur les tétines.

- 4** Placez les capuchons sur le porte-capuchons (fig. 14).

Quatre pots de conservation Philips AVENT avec couvercles

- 1** Placez les pots de conservation à l'envers dans le panier (fig. 15).
- 2** Insérez les couvercles à la verticale entre les pots. (fig. 16)

Utilisation du stérilisateur pour micro-ondes

Ne placez dans le stérilisateur que des objets pouvant être stérilisés. Ne stérilisez pas les goupillons de biberon, ni aucun élément rempli de liquide comme les sucs contenant du liquide froid pour calmer la douleur.

Remarque : Prenez le temps de nettoyer les biberons et les autres objets avant de les stériliser.

- 1** Retirez le panier de la base.
- 2** Versez précisément 200 ml (7 oz) d'eau du robinet dans la base à l'aide d'un biberon ou d'un gobelet gradué (fig. 2).

Veillez à utiliser très exactement 200 ml (7 oz) d'eau car si vous en utilisez trop, la stérilisation ne se déroulera pas correctement et si vous n'en utilisez pas assez, vous risquez d'endommager le stérilisateur ou le micro-ondes.

- 3** Déposez le panier dans la base (fig. 3).
- 4** Placez dans le panier les éléments à stériliser (voir la section «Avant l'utilisation»).
- 5** Placez le couvercle sur le stérilisateur (1) et appuyez sur les attaches pour le maintenir en place (2) (fig. 4).
- 6** Placez le stérilisateur dans le micro-ondes. (fig. 5)

Remarque : Assurez-vous que le micro-ondes est propre et sec avant de lancer la stérilisation.

- 7** Choisissez la puissance et la durée appropriée (voir le tableau de la section «Utilisation du stérilisateur pour micro-ondes») et démarrez le micro-ondes.

Remarque : Si vous utilisez un four combiné, veillez à ce que le four ou le grill soit éteint et froid avant d'insérer le stérilisateur.

Remarque : Ne dépassez pas la durée de stérilisation indiquée dans le tableau.

Puissance et durée à régler sur le micro-ondes

Puissance	Durée de stérilisation	Durée de refroidissement
1 200 à 1 850 W	2 min.	2 min.
850 à 1 100 W	4 min.	2 min.
500 à 800 W	6 min.	2 min.

- 8** Une fois le cycle terminé, ouvrez le micro-ondes et laissez le stérilisateur refroidir avant de l'en retirer.

Restez vigilant, car il est possible que de la vapeur chaude s'échappe du micro-ondes.

- 9** Retirez le stérilisateur du micro-ondes.

Remarque : Vérifiez que le stérilisateur est bien à plat pour éviter tout risque de fuite d'eau chaude.

Remarque : Les objets stérilisés peuvent rester stériles jusqu'à 24 heures au sein du stérilisateur pour micro-ondes, tant que vous n'ouvrez pas le couvercle.

10 Soulevez les attaches (1) et retirez le couvercle (2) (fig. 6).

11 Retirez les biberons et les autres objets du panier en vous servant des pinces pour saisir ceux de petite taille.

Restez prudent car de la vapeur brûlante peut s'échapper du stérilisateur et les objets stérilisés peuvent encore être très chauds.

12 Une fois que vous avez retiré les objets du stérilisateur, videz l'eau restante, rincez soigneusement la base et le panier et essuyez chaque pièce.

Nettoyage

Nettoyez le couvercle, le panier et la base après chaque utilisation.

N'utilisez jamais de tampons à récurer, de nettoyants abrasifs ou de produits puissants tels que de l'eau de Javel, de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

Remarque : Laissez le stérilisateur refroidir avant de le nettoyer.

1 Nettoyez les différentes pièces du stérilisateur avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle.

Remarque : Vous pouvez aussi nettoyer les pièces du stérilisateur au lave-vaisselle.

2 Une fois les pièces nettoyées, essuyez-les.

Remarque : Une fois nettoyé, rangez le stérilisateur dans un endroit propre et sec.

Les éléments de ce produit ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur. Pour obtenir de l'aide, appelez le 1 800 54-Avent (1 800 542-8368).

Garantie

Garantie d'un an complète

Philips garantit ses produits pendant une période déterminée à compter de la date d'achat. Si le produit est acheté aux États-Unis, Philips North America LLC (États-Unis) ou, s'il est acheté au Canada, Philips Electronics Ltd., garantit ce nouveau produit contre tout défaut matériel ou vice de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat (comme l'atteste une preuve d'achat valide), et s'engage à remplacer n'importe quel produit défectueux sans frais. Philips remboursera le prix d'achat s'il ne parvient pas à remplacer le produit.

Les pièces sujettes à l'usure normale, les accessoires, les piles de rechange et les consommables tels que les têtes de brosse à dents ne sont pas couverts par cette garantie.

IMPORTANT : Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, une utilisation incorrecte ou abusive, une négligence, l'ajout de tout embout non fourni avec le produit, la perte de pièces ou l'utilisation d'un voltage autre que celui spécifié pour le produit.*

AUCUNE RESPONSABILITÉ N'EST PRISE EN CHARGE POUR LES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS.

Pour obtenir plus d'informations et pour bénéficier du service de garantie, il vous suffit d'accéder au site **www.philips.com/support**.

REMARQUE : Cette garantie vous permet de bénéficier de droits spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits, en fonction des différents états, provinces et

pays. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs. Ainsi, les limitations ou exclusions ci-avant peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie est transférable.

*Lisez attentivement les instructions fournies.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES CAS SUIVANTS :

- Dommages indirects ou consécutifs tels que la perte de temps, la perte de données ou la perte de revenu. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs. Par conséquent, il est possible que la limitation présentée ci-dessus ne s'applique pas à votre cas.
- Compensation pour des activités effectuées par vous-même, telles qu'une maintenance régulière, l'installation de mises à jour du micrologiciel ou la sauvegarde de données.

LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX CAS SUIVANTS :

- Si la preuve d'achat, le numéro de modèle, le numéro de série ou le code de date de production du produit a été rendu illisible.
- Si le produit a été acheté en provenance d'un stock défectueux.
- Si le défaut est le résultat d'une utilisation abusive ou excessive, en dehors de l'objectif prévu.
- Si le défaut est dû aux conditions environnementales, à la connexion de périphériques, d'équipements supplémentaires ou d'accessoires (y compris le logiciel) qui ne sont pas conformes au mode d'emploi.
- Si l'unité a été endommagée, y compris mais sans s'y limiter, par des animaux, des éclairs, une tension anormale, un incendie, une catastrophe naturelle, un transport ou de l'eau (à moins que le mode d'emploi n'ait expressément indiqué que le produit peut être rincé).
- Pour les composants non électriques, l'usure normale, les accessoires, les piles de rechange ou le remplacement de pièces consommables telles que les têtes de brosse à dents.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement, car il n'a pas été conçu à l'origine pour le pays où il est utilisé, ce qui peut arriver s'il est importé.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement en raison de problèmes de connexion avec des fournisseurs de services, tels qu'Internet.

Fabriqué pour :

Philips Personal Health

Une division de Philips North America LLC

P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904, USA.

Au Canada : Philips Electronics Ltd

281 Hillmount Road, Markham, ON L6C 2S3

